



**REGIO**MED

# Auftrag zur Kalibrierung von Temperatursensoren

**Ich möchte folgende Temperatursensoren kalibrieren lassen:**

**Menge:**

**Preis / Stk.**

9993719 TFA Kalibrierung Temperatursensor

CHF 110.00

9993722 TESTO Saveris Kalibrierung Temperatursensor

CHF 125.00

**Ich benötige Ersatzlogger:**

**Menge:**

**Preis / Stk.**

9990546 Thermometer LT-102 - Ersatzgerät  
für ~~Raumtemperatur~~

gratis

9990547 Thermometer LT-102 - Ersatzgerät  
für ~~Kühlschrank~~

gratis

Wenn Sie die Ersatzlogger von uns erhalten haben, dann können Sie uns Ihre Logger zur Kalibrierung senden.

**Praxisadresse/Praxisstempel:**

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. - Produkt- und Preisänderungen vorbehalten.


**Haben Sie Fragen zu unserem Sortiment? Wir beraten Sie gerne.**



**RegioMed GmbH** · Oberdorfweg 9 · CH-5610 Wohlen AG  
regiomed.ch · Info@regiomed.ch · +41 56 618 46 56


Damit Sie während der Kalibrierungszeit keine Fehlermeldungen erhalten, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

## TFA Sensor:

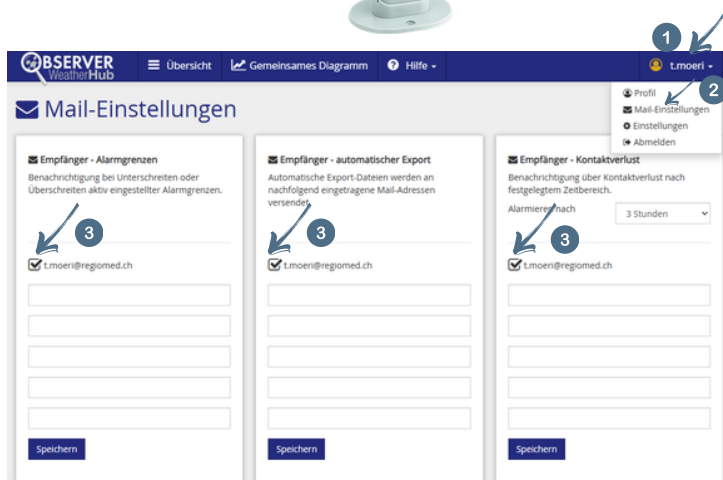

- 1 Loggen Sie sich unter [www.wh-observer.de](http://www.wh-observer.de) mit Ihrem Profil ein.
- 2 Gehen Sie über Ihre Benutzer-Einstellungen zu den Mail Einstellungen.
- 3 Entfernen Sie alle Häkchen wie auf dem Bild ersichtlich.
- 4 Wählen Sie die Häkchen wieder an, nachdem Sie Ihren Sensor retour erhalten haben.

## TFA.ME Sensor

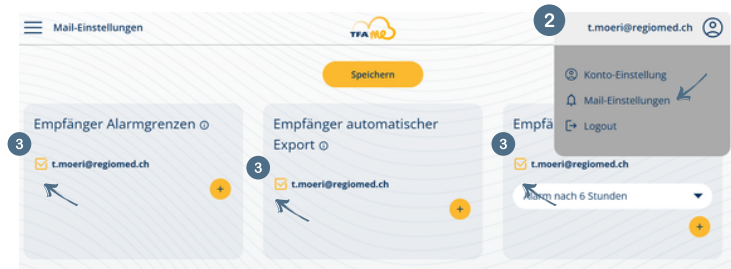

- 1 Loggen Sie sich unter <https://go.tfa.me> mit Ihrem Profil ein.
- 2 Gehen Sie über Ihre Benutzer-Einstellungen zu den Mail Einstellungen.
- 3 Entfernen Sie alle Häkchen wie auf dem Bild ersichtlich.
- 4 Wählen Sie die Häkchen wieder an, nachdem Sie Ihren Sensor retour erhalten haben.

